


新規医療関連機器圧迫創傷（MDRPI）発生率

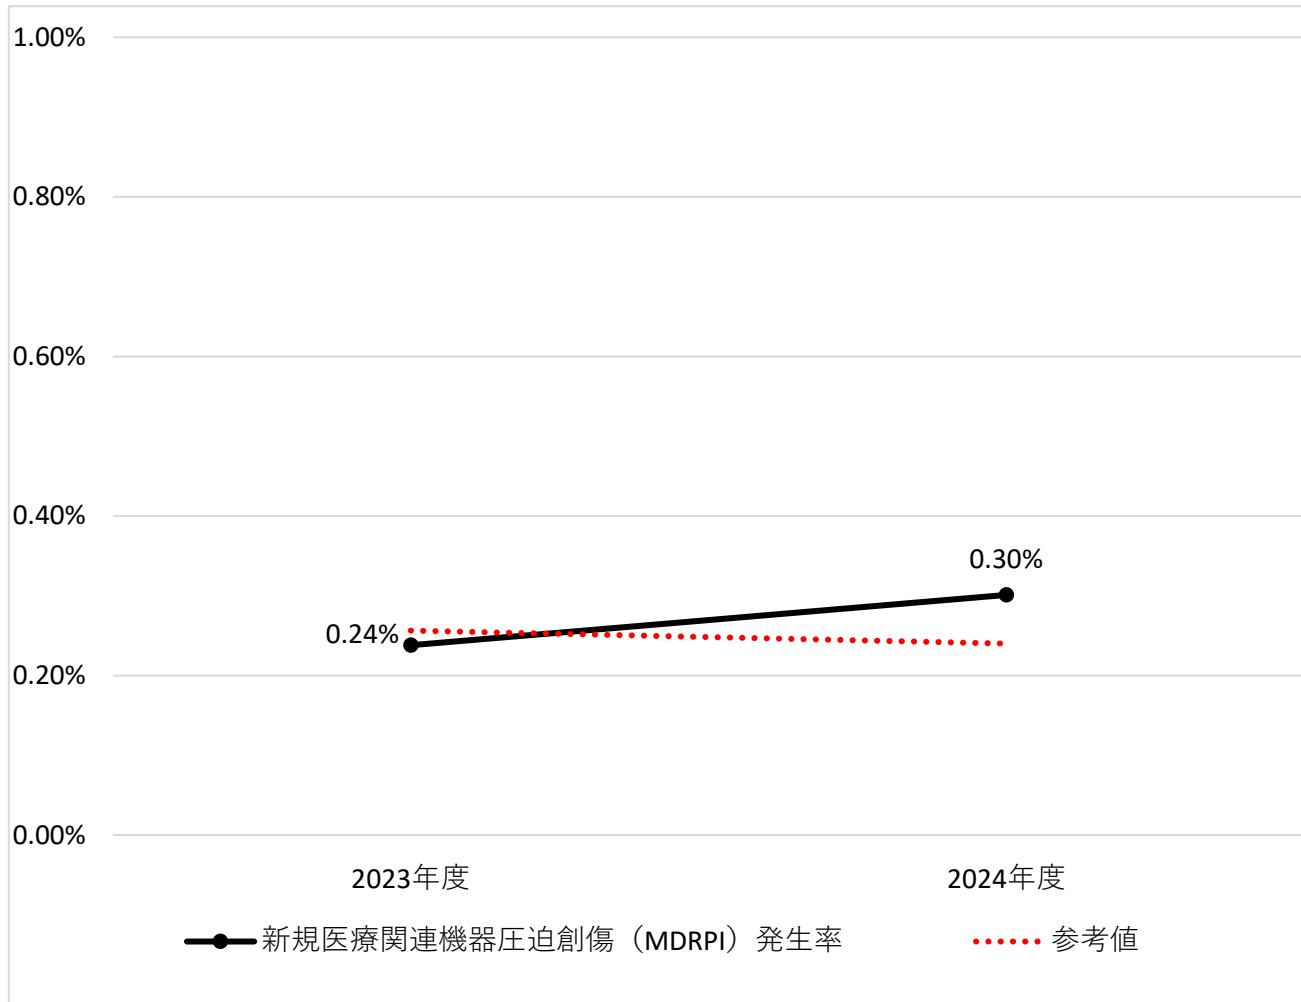

分子	調査月の新規医療関連機器圧迫創傷（Medical Device Related Pressure Injury : MDRPI）発生患者数
分母	調査期間初日(0時時点)の入院患者数 + 調査期間に新たに入院した患者数
参考値	QIプロジェクト参加施設の平均値
説明	<p>[指標の意義]</p> <p>MDRPIは、医療行為に伴って発生する合併症の一つであり、医療機器の使用による圧迫で皮膚や粘膜に損傷が生じるものです。発生率を把握することで、医療の質と安全性、ケアの丁寧さや予防策の実施状況を客観的に評価することができます。</p> <p>[結果]</p> <p>2024年度は参考値（0.25%）を上回りました。今後、注意深く推移を見ていく必要があります。</p>